



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457, ОГРН: 1255000000034, Номер телефона: +7 4955422222, Адрес электронной почты: info@iek.ru

В лице: Руководителя направления Гусакова Ростислава Владимировича на основании доверенности № 19838e05-cbb2-44be-9811-910444b58f0f

заявляет, что Инструмент ручной товарного знака IEK, серии ARMA2L: отвертка-пробник типа ОП-1Т входящая в том числе в наборы артикулов: A2L5-NS30-T2-06, A2L5-NS30-T2-09, A2L5-NS30-T3-06, A2L5-NS30-T3-09

Изготовитель: "YIH CHENG FACTORY CO., LTD."

Место нахождения: ТАЙВАНЬ (Китай), NO.103, NAN KANG 3 ROAD, NAN KANG INDUSTRIAL AREAS, NAN TOU, 540029

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO.103, NAN KANG 3 ROAD, NAN KANG INDUSTRIAL AREAS, NAN TOU, 540029, 23.942647, 120.663262

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: GB 4793.5-2008 (IEC 61010-031.2002, IDT) «Требования к безопасности электрооборудования для проведения измерений, управления и лабораторного использования. Часть 5. Требования безопасности к портативным измерительным щупам для электрических измерений и испытаний»

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8205400000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 028-06-23-ВТ от 01.06.2023, выданного Испытательной лабораторией «Вольтекс» ООО «ПрофНадзор». Свидетельство о признании компетентности: № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121 от 22.06.2022.

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация: Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

"ГОСТ IEC 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"", "ГОСТ IEC 61010-031-2013

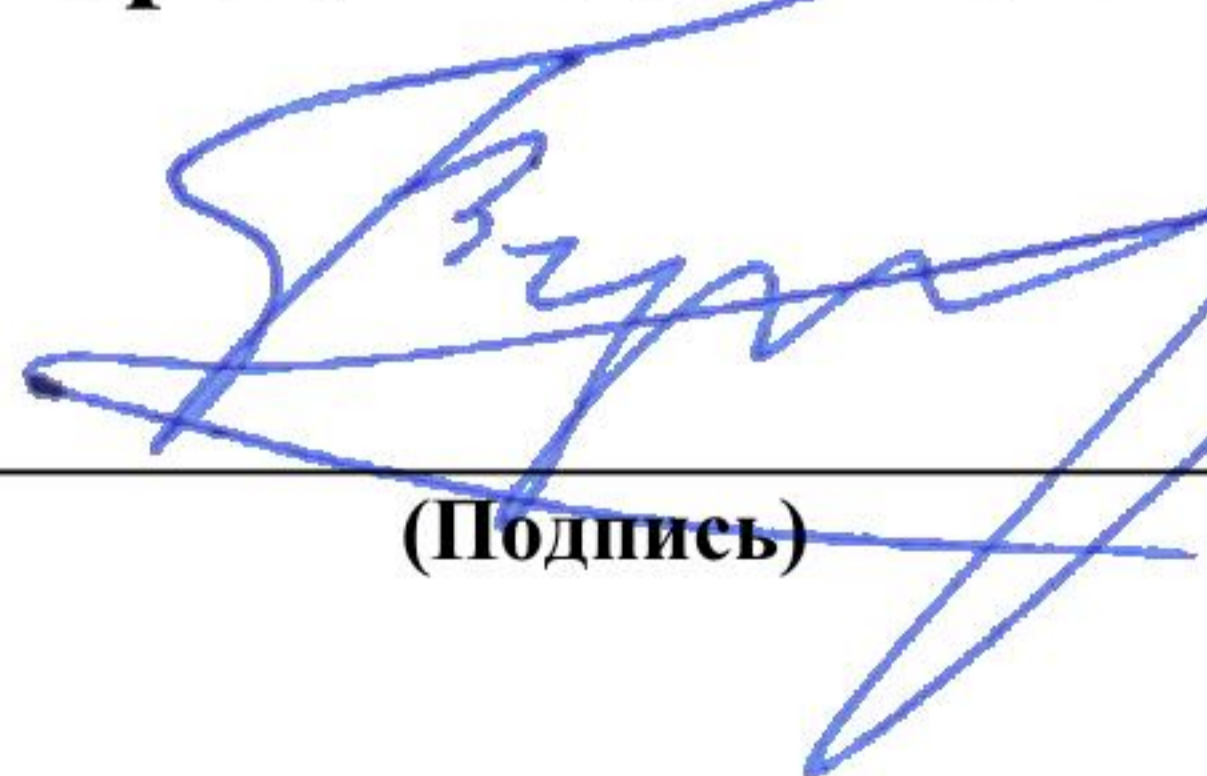
"Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 031. Требования безопасности к портативным измерительным щупам для электрических измерений и испытаний""

Договор уполномоченного лица № 218904 от 01.01.2022

Дата изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания: 04.2023 г.

Декларация принята взамен ЕАЭС N RU Д-TW.PA01.B.48830/25 от 28.01.2025

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.06.2028 включительно


(Подпись)



М.П.

Гусаков Ростислав Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-TW.PA02.B.72107/26

Дата регистрации декларации о соответствии:

20.03.2026